МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МЕДТЕХНИКА"

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ФЛЮОРОМАММОГРАФИЧЕСКОЕ ПФ-01

Паспорт

Н 57.00.000 ПС

1979г.

Приспособление флюромаммографическое предназначено для укладки, компрессии и съемки молочных желез флюорографическими аппаратами II-ФI, ТУР-ДБ-3IO, "Сериомета", "Серикс" с целью выявления патологических изменений при массовом флюрогравическом обследовании женщин в лечебно-профилактических учреждениях.

Габаритные размеры приспособления:

Ширина	- 100 мм.
Высота	- 495 мм.
Длина	- 454 мм.

Минимальное расстояние между компрессующими пластинами 45 мм.; максимальное 256 мм.

Ход пластин в вертикальной плоскости 200 мм.

Приспособление состоит из направляющей штанги, соединенной с флюорографическим аппаратом посредством фланцев, и двух фиксируемых кареток с компрессующими пластинами. Компрессующие пластины при помощи установочных винтов выставляются по центру рентгеновской трубки.

В комплект изделий входит приспособление, паспорт и сменные компрессующие элементы.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Приспособление с помощью фланцев крепится под экраном флюорографического аппарата или на противоположной экрану стенке кабины. Поворотное устройство позволяет устанавливать приспособление в рабочем положении или отводить в сторону.

Компрессующие пластины, предназначенные для укладки и компрессии молочных желез, крепятся к штангам, перемещаются вертикально и фиксируются относительно каретки винтами.

Компрессия молочных желез осуществляется перемещением по направляющей кареток при нажатии на рукоятку эксцентрика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Приспособление флюоромаммографическое Н 57.00.000 заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 42-2-324-77 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска "___" _____ 197_ г.

М.П.

Контролер ОТК

Контролер № 3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществляется ремонтным предприятием системы "Медтехника", обслуживающим учреждения здравоохранения в данной области, крае, республике за счет завода-изготовителя.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивается учреждением-владельцем изделия.

Адрес завода: г.Москва 113093 Дубининская ул. дом 98
Электромеханический завод Московского
Городского Управления "Медтехника".

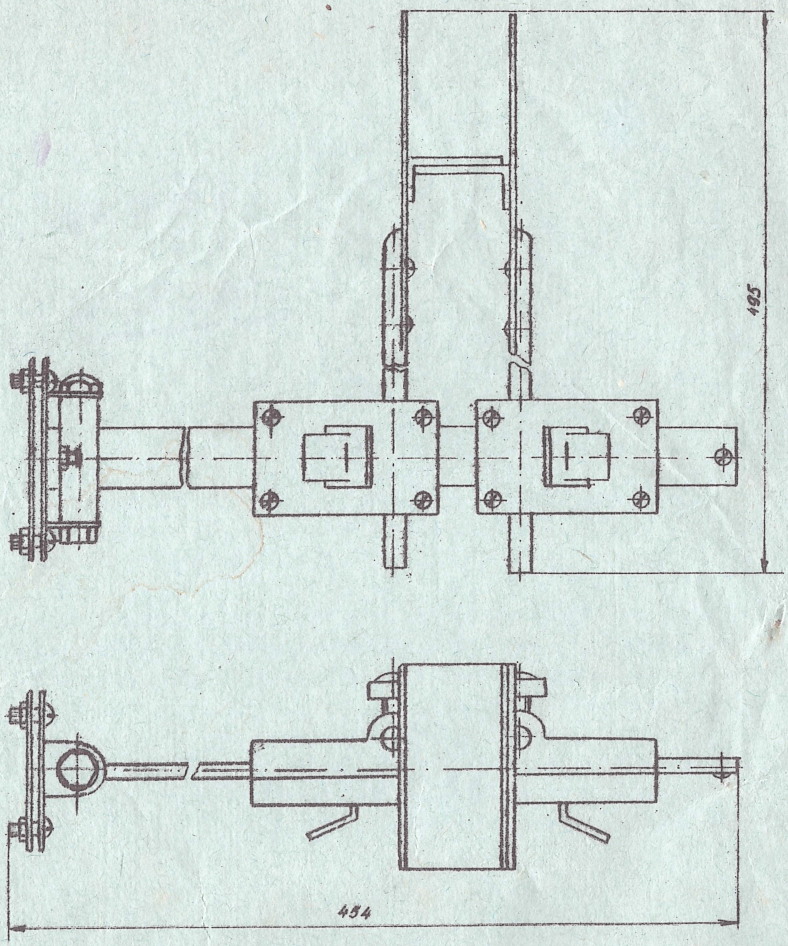

Пушк. тип. Моск. обл. Зак. 2980–79г.